

POUR VOUS INSCRIRE :
Merci de retourner ce coupon-réponse complété par mail

COUPON-RÉPONSE

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone :

Fax :

E-mail :

Centre d'AMP :

- Participera à la réunion SAMPIL du jeudi 14 novembre 2024
- Ne participera pas à la réunion SAMPIL du jeudi 14 novembre 2024



Réponse souhaitée avant le 5 novembre 2024

Par mail : leslie.gire-lelaidier@merckgroup.com


MERCK

DENSMORE
LABORATOIRES

MERCK

DENSMORE
LABORATOIRES

Avec le soutien
institutionnel de
Merck et Densmore

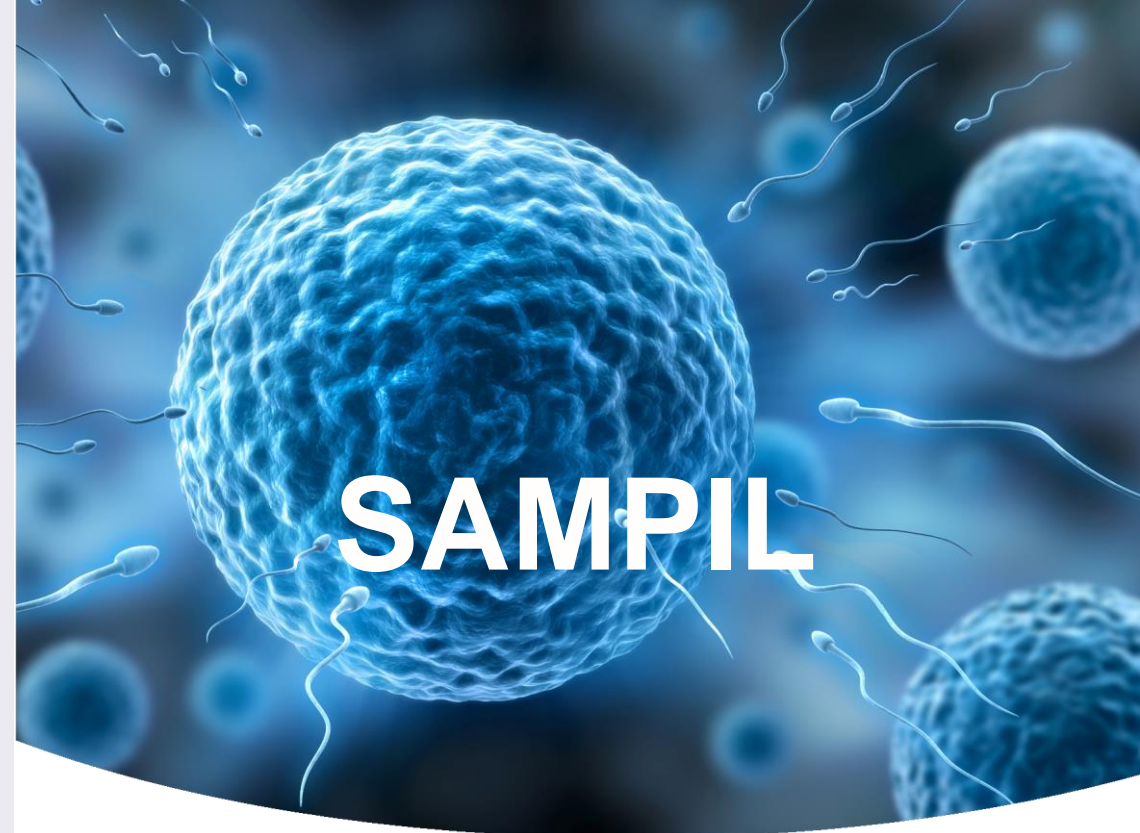

SAMPIL

INVITATION SOIRÉE SCIENTIFIQUE

Jeudi 14 Novembre 2024

**GRANDE SOIRÉE SAMPIL : L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE EN INFERTILITÉ ET AMP, UNE
AMÉLIORATION DES PRATIQUES ?**

Retrouvez-nous sur www.sampil.fr



Cher(e) Collègue,

L'association SAMPIL est heureuse de vous retrouver sur des thèmes d'actualité en AMP et vous invite à la réunion scientifique qui aura lieu :

Le jeudi 14 novembre 2024

A 20H30

Cocktail dinatoire dès 19H30

**L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN
INFERTILITÉ ET AMP,
UNE AMÉLIORATION
DES PRATIQUES ?**

HOTEL BEDFORD PARIS

17 rue de l'Arcade
75008 PARIS

STAFFS A.M.P.
PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Comité scientifique :

Présidente :

Dr S. Alvarez

Bureau :

Dr A. Clément

Dr L. Jacquesson

Dr C. Maignien

Dr C. Sifer

Dr M. Bourdon

Dr M. Dahoun

Membres fondateurs :

Dr S. Alvarez

Dr E. Sedbon

Dr P. Zitoun

RÉUNION SAMPIL

Jeudi 14 novembre 2024

Coordination générale : Silvia Alvarez

Coordinateurs de la soirée :

Chloé Maignien et Christophe Sifer

20H30 – 20H50

LA STIMULATION OVARIENNE: SIMPLIFIER LE PARCOURS PATIENTE AVEC L'IA ; Le monitoring de la stimulation ovarienne à distance

Dr N. PRISANT – Chief Medical Officer – IMMA HEALTH

20H50 – 21H10

L'IA REMPLACERA LE DPI DANS LE CHOIX DE L'EMBRYON ?

Pr D. SEIDMAN – Co founder and chief medical officer AIVF, Associate Professor in GO Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University Israël

21H10 – 21H40

SÉLECTION DES SPERMATOZOÏDES PAR L'IA AVANT ICSI. ALGORITHMES ET EXPRESSION GÉNIQUE

Dr G. CASSUTO – Directeur Laboratoire DROUOT Paris

